



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde


Rua José Ortiz de Camargo, 594 - CEP: 18.270-500 - Tatuí - SP
Fone: (0XX15) 3305-8855

Tatuí, 05 de Abril de 2018.

OFÍCIO N°. 429/2018 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio do presente prestar informações a Vossa Senhoria com relação ao **Requerimento 551/2018** emitido pela Câmara Municipal de Tatuí a fim de que se de resposta à referida Casa Legislativa, conforme relatório emitido pela Coordenação do respectivo setor, em anexo.

Sem mais para o momento, deixamos votos de alta estima e consideração.


Jerônimo Fernando Dias Simão
Secretário Municipal de Saúde.

Ao Ilmo. Sr.
RENATO PEREIRA DE CAMARGO
Secretario Municipal de Negócios Jurídicos



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ
Instituição Filantrópica – Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal
Desde 08/07/1895 - CNPJ 72.189.582/0001-07

Tatuí, 05 de abril de 2018.

Ofício: 070/2018

A
Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí
Nesta

A/C- Sr. Jerônimo Fernando Dias Simão

Ref. – Requerimento 551

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, representada nos termos do Decreto Municipal nº 18.114 de 27 de setembro de 2017, como Interventora Municipal que esta subscreve Sra. Márcia Aparecida Giriboni de Souza, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência expor:

Informamos que o aparelho sofreu um dano elétrico no dia 01/03 e estamos em processo de manutenção e correção do defeito. Aguardamos para o dia de hoje 05 de abril no período da tarde, conforme relatórios anexos.

Sendo o que tínhamos a expor para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração,

Atenciosamente,

Santa Casa de Misericórdia de Tatuí

Márcia Aparecida Giriboni de Souza

Radious

Campinas, 27 de Março de 2018

À

Santa Casa de Misericórdia de Tatuí / SP

A/C: Fabio (radiologia) / Beth (administração)

Ref.: Equipamento de Raios-X Siemens


Prezado(a) Senhor(a)

Conforme sua solicitação, vimos por meio desta informar que em relação ao equipamento de **Raios-X marca Siemens modelo Multix B**, realizamos visita para verificação de defeito em 26/03/2018, e que após avaliação constatamos necessidade de reparos em circuitos de alimentação e controle do filamento do tubo, a fim de eliminar o erro apresentado. Assim sendo retiramos o transformador de alta tensão e as placas D109 e D103 para elaboração de orçamento e devidos reparos.

Informamos também que o prazo estimado para devolução dos mesmos é de 10 (dez) dias, previsão de retorno em 05/04/2018.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

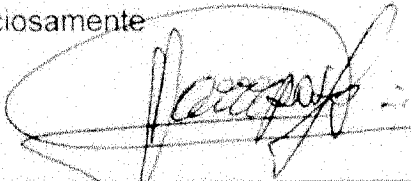

Salvador Leite de Campos Junior

Engenheiro Eletricista CREA 5.063.755.999

Especialista em Equipamentos de Raios-X e Ultrassom



Radious Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. - ME

Rua Christina Giordano Miguel Nº 332 - Jd. Sta. Genebra II - Campinas / SP - CEP 13.084-752

Fone/Fax (19) 3256.4762 www.radious.com.br e-mail: contato@radious.com.br

Radious

Campinas, 04 de Abril de 2018

À

Santa Casa de Misericórdia de Tatuí / SP

A/C: Fabio (radiologia) / Beth (administração)

Ref.: Equipamento de Raios-X Siemens

Prezado(a) Senhor(a)

Conforme sua solicitação, vimos por meio desta informar que em relação ao equipamento de **Raios-X marca Siemens modelo Multix B**, realizamos a verificação de possíveis defeitos nas placas D109 e D103 que retiramos, não constatando falhas neelas. Com relação ao transformador constatamos problemas nas saídas de leitura de corrente e de alta tensão, que já resolvemos. No entanto esse problema do transformador não causaria o erro que o equipamento vem apresentando. Assim sendo retornaremos conforme combinado em 05/04/2018 para reinstalação das placas e transformador e continuação da pesquisa de defeitos, agora com maior clareza e chances de solução.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



Salvador Leite de Campos Junior

Engenheiro Eletricista CREA 5.063.755/999

Especialista em Equipamentos de Raios-X e Ultrassom

10.549.322/0001-48

RADIOUS EQUIPAMENTOS MÉD.
HOSPITALARES LTDA

R Christina Giordano Miguel, nº 332
Jd. Santa Genebra - CEP: 13084 - 752

CAMPINAS - SP

Radious Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. - ME

Rua Christina Giordano Miguel Nº 332 - Jd. Sta. Genebra II - Campinas / SP - CEP 13.084-752

Fone/Fax (19) 3256.4762 www.radious.com.br e-mail: contato@radious.com.br